SLAC Magnetic Measurements#
Date: 08-09-2021#
Time: 08:39:59#

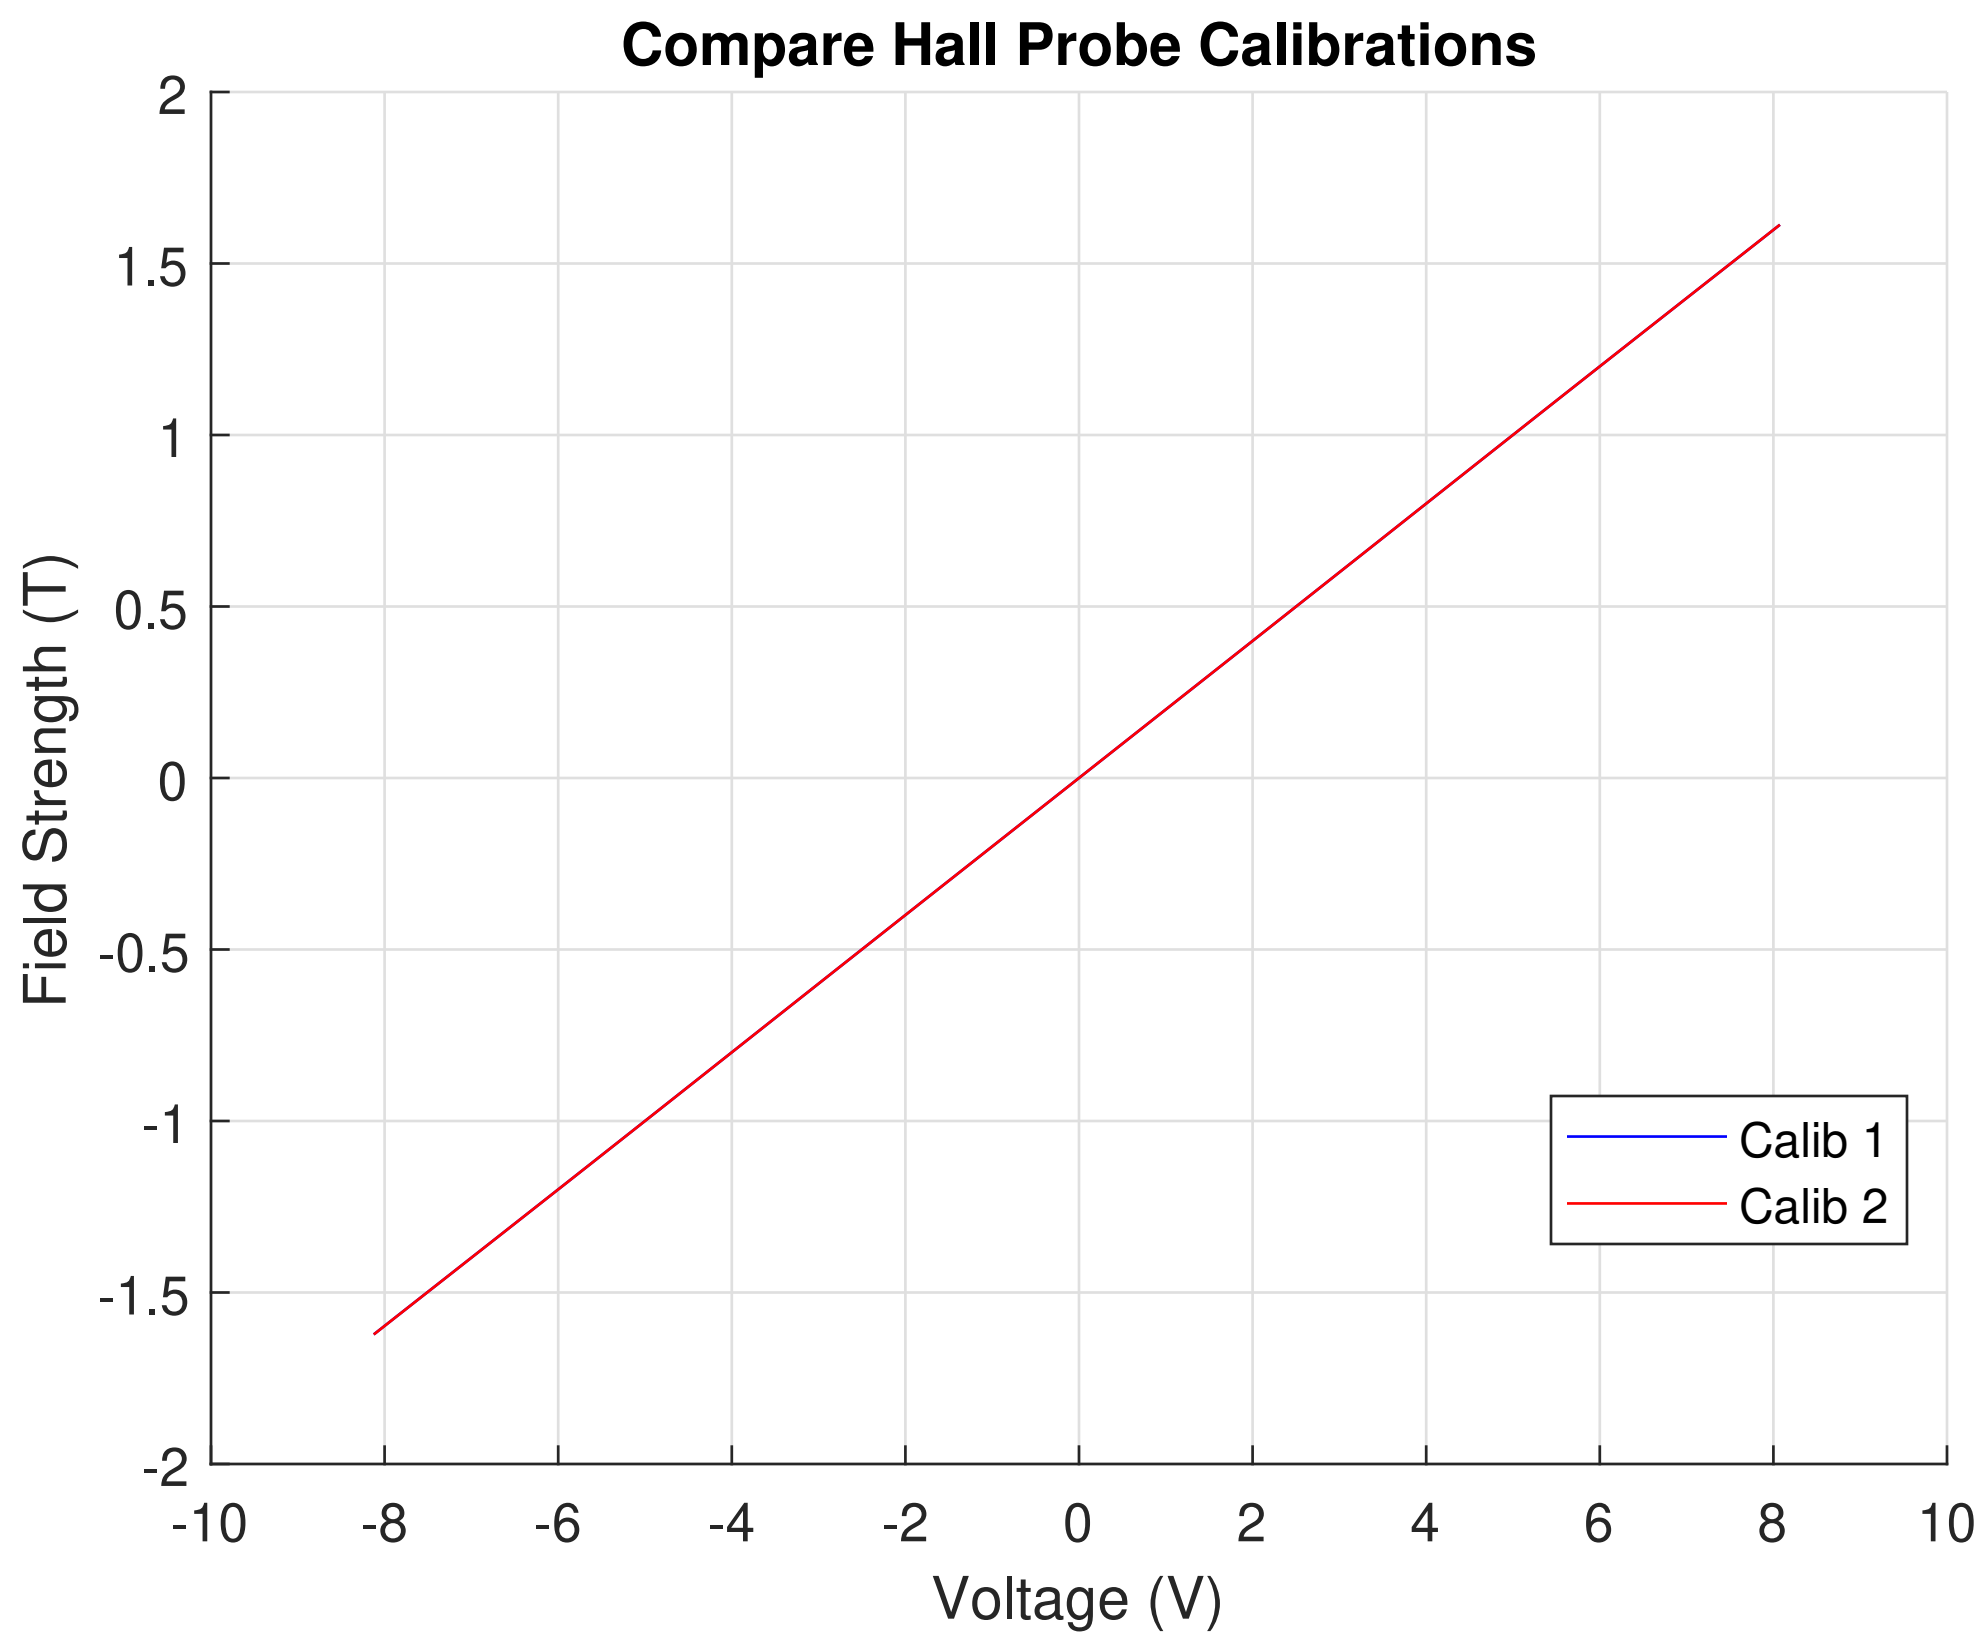

Compare Hall Probe Calibrations
Field Strength (T)
2
1.5
1
0.5
0
-0.5
-1
-1.5
-2
-10
-8
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
10
Voltage (V)
Calib 1
Calib 2

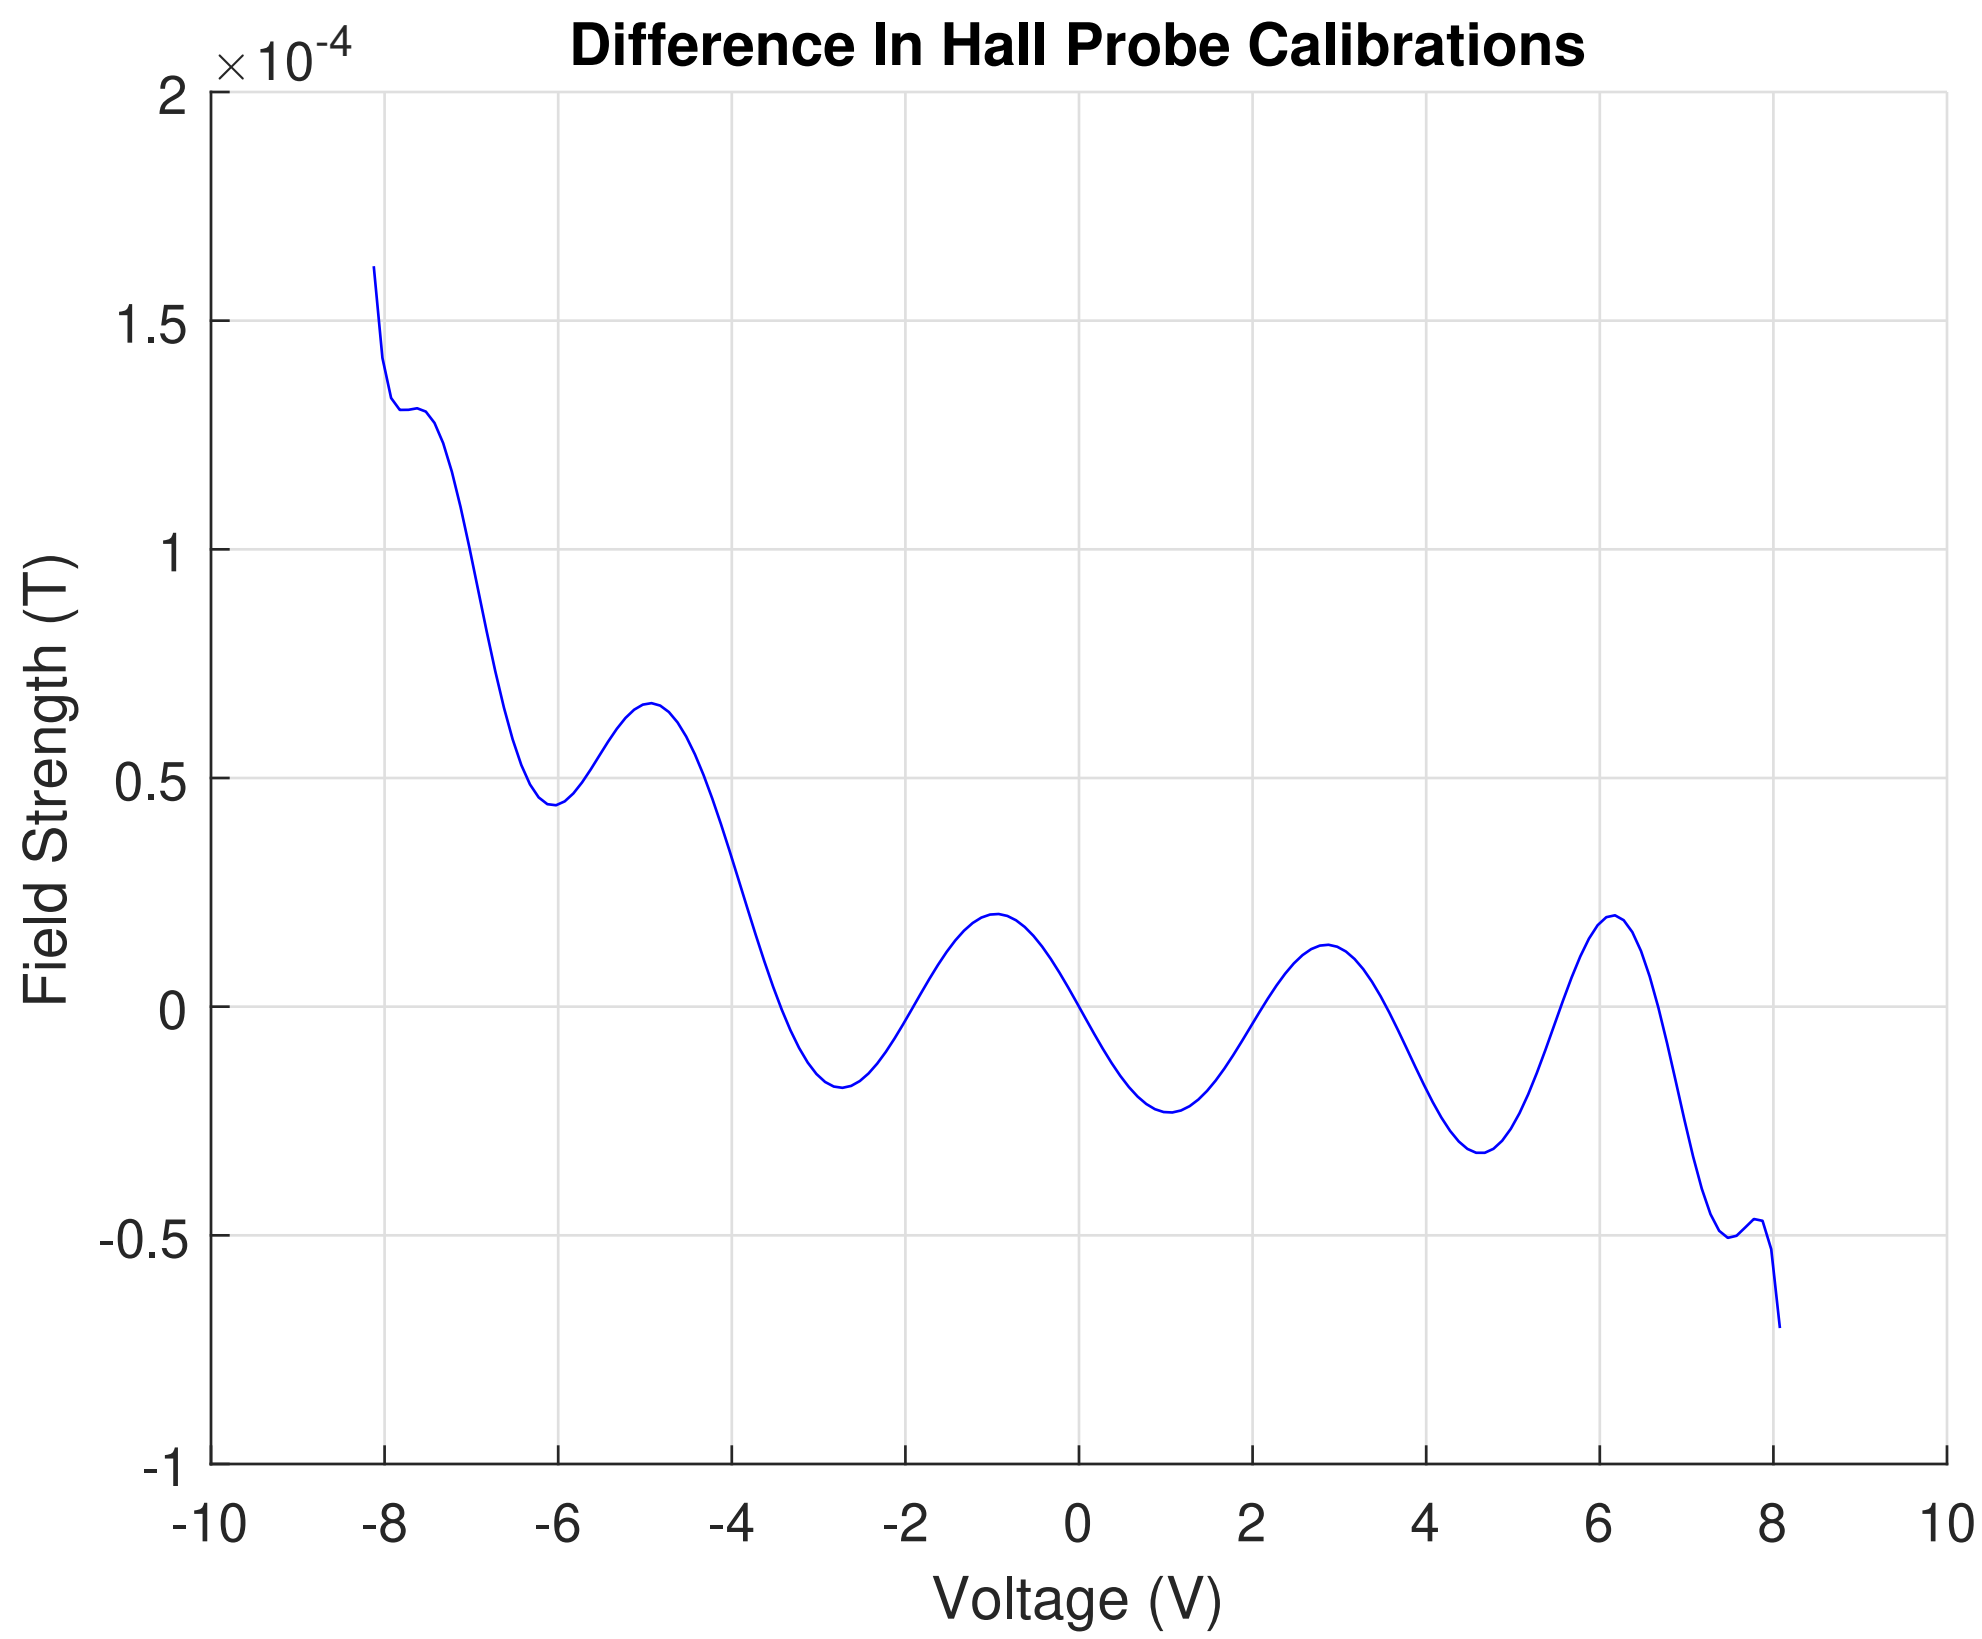
Difference In Hall Probe Calibrations
×10^-4
2
1.5
1
0.5
0
-0.5
-1
Field Strength (T)
-10
-8
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
10
Voltage (V)