SLAC Magnetic Measurements
Hall Probe Calibration

Header:
SLAC Magnetic Measurements
Date: 01−23−2013
Time: 11:08:25

Project: LCLS
Device Type: Hall probe
Data Type: x
Serial Number: SENIS−119−12
Run Number: 1
Measurement Type: HPCS
Operator: YL
Comment: calibration +−1.0T; x−probe calibration

Current(A) T(C) Est. Field(T) Voltage Field

Parameters:
INPUT−FILE−DIR =s:\MagData\LCLS\Hall probe\SENIS−119−12\HPCS−001\
INPUT−FILE−NAME =hpcs−dat.001
POLY−FIT−ORDER =10
NUM−SIG−OUTLIER =2
NOM−CALIB−CONST =0.2
MAX−B−NMR−FIT =1

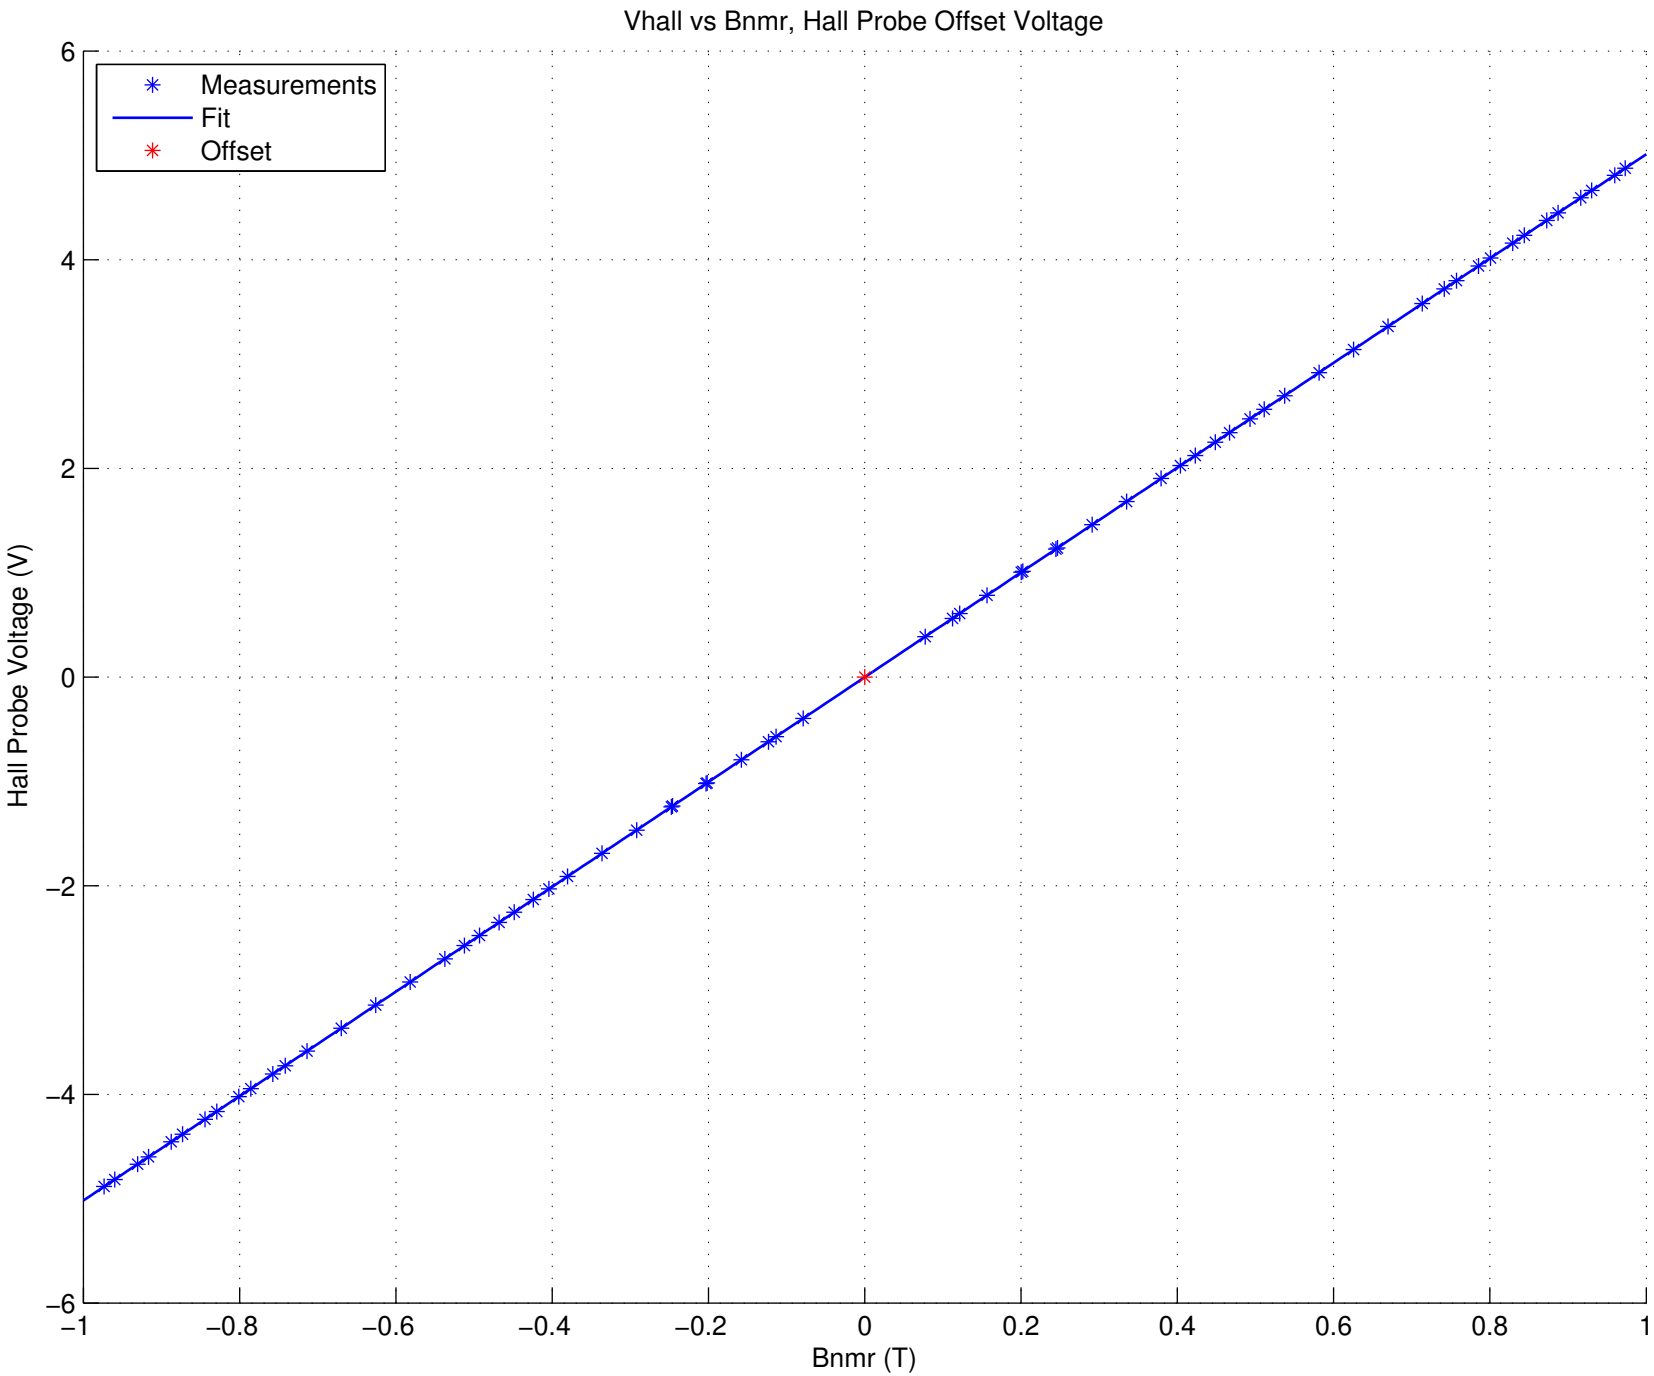
Vhall vs Bnmr, Hall Probe Offset Voltage
Measurements
Fit
Offset
Hall Probe Voltage (V)
Bnmr (T)
6
4
2
0
−2
−4
−6
−1
−0.8
−0.6
−0.4
−0.2
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1

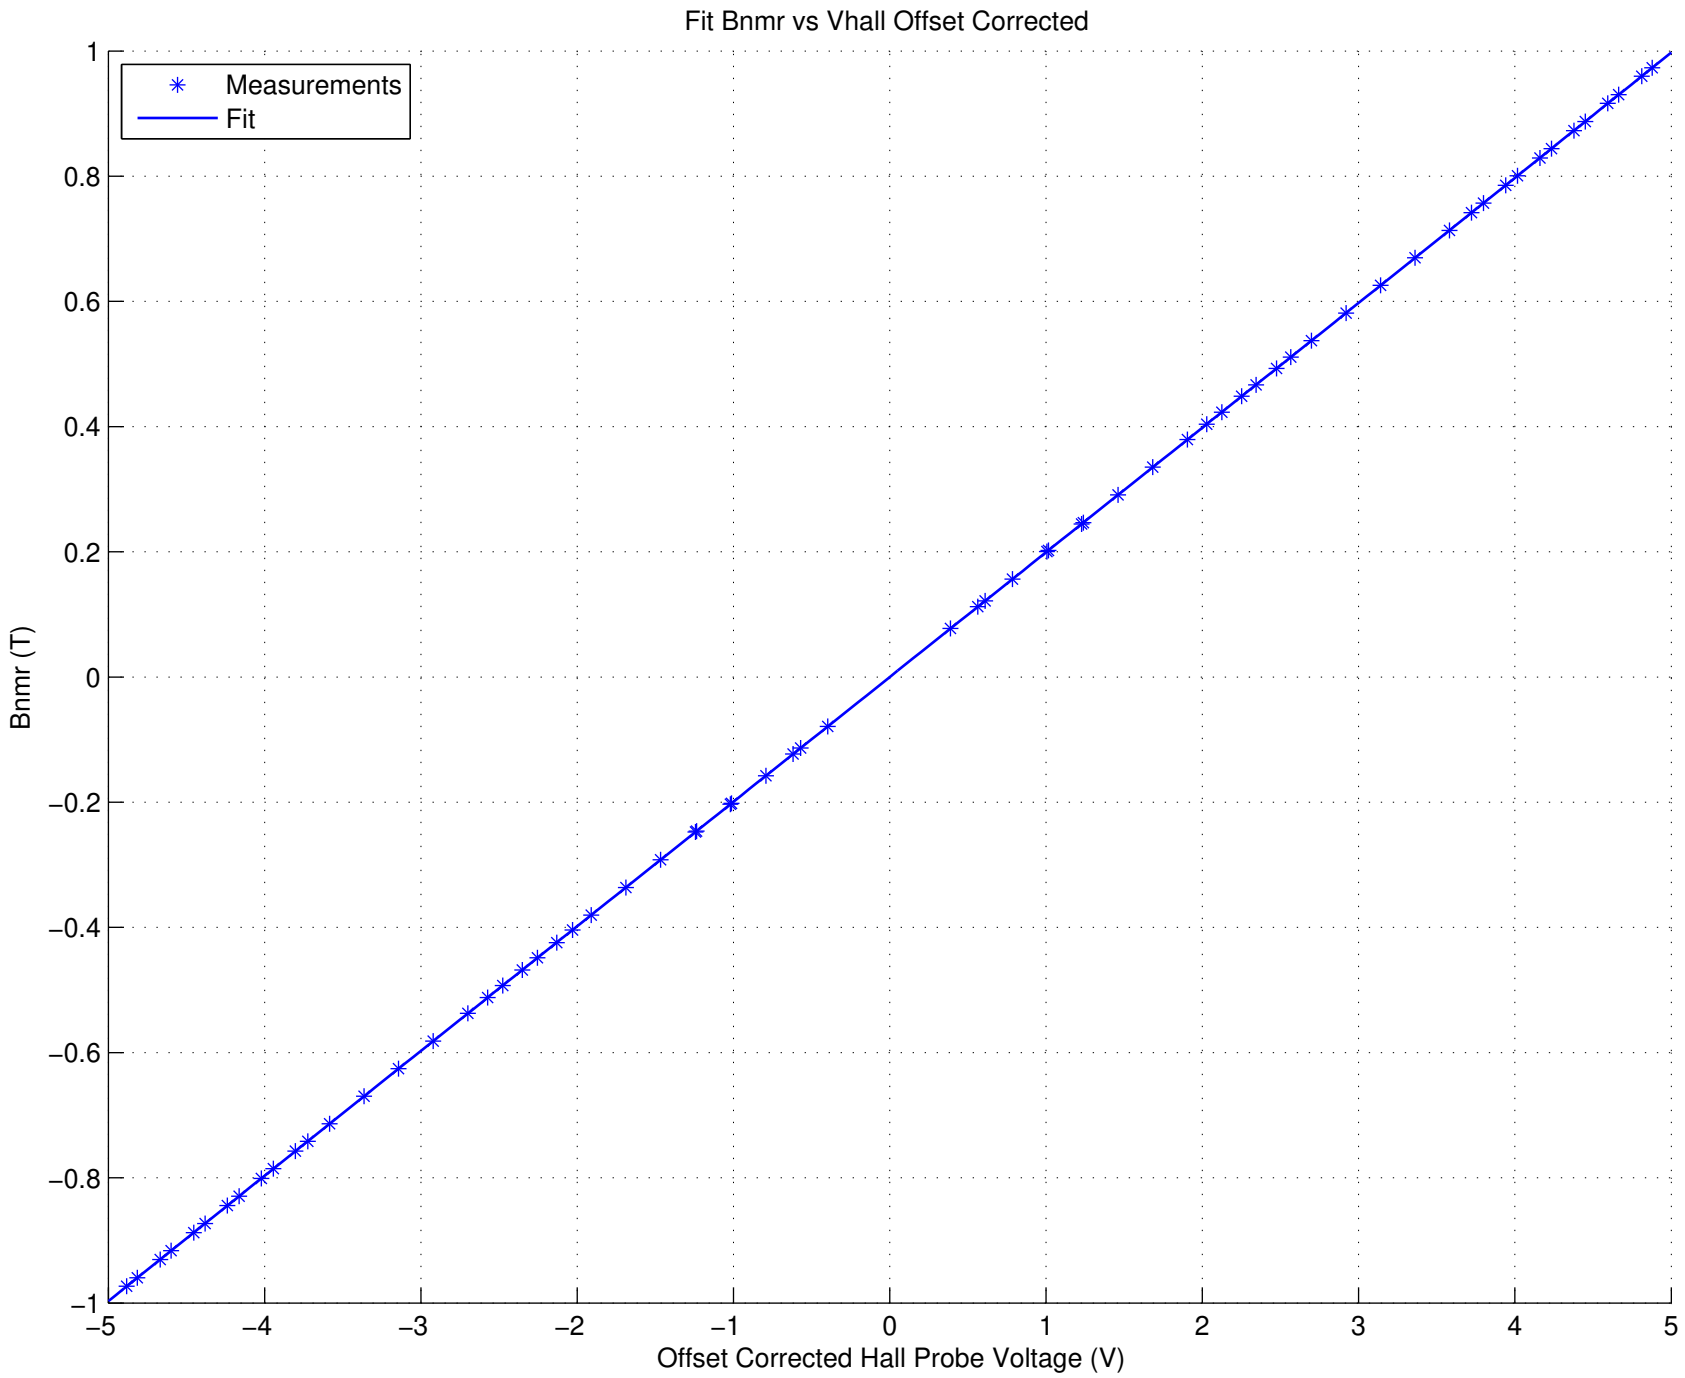
Fit Bnmr vs Vhall Offset Corrected
Measurements
Fit
Bnmr (T)
Offset Corrected Hall Probe Voltage (V)
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
−0.2
−0.4
−0.6
−0.8
−1
−5
−4
−3
−2
−1
0
1
2
3
4
5

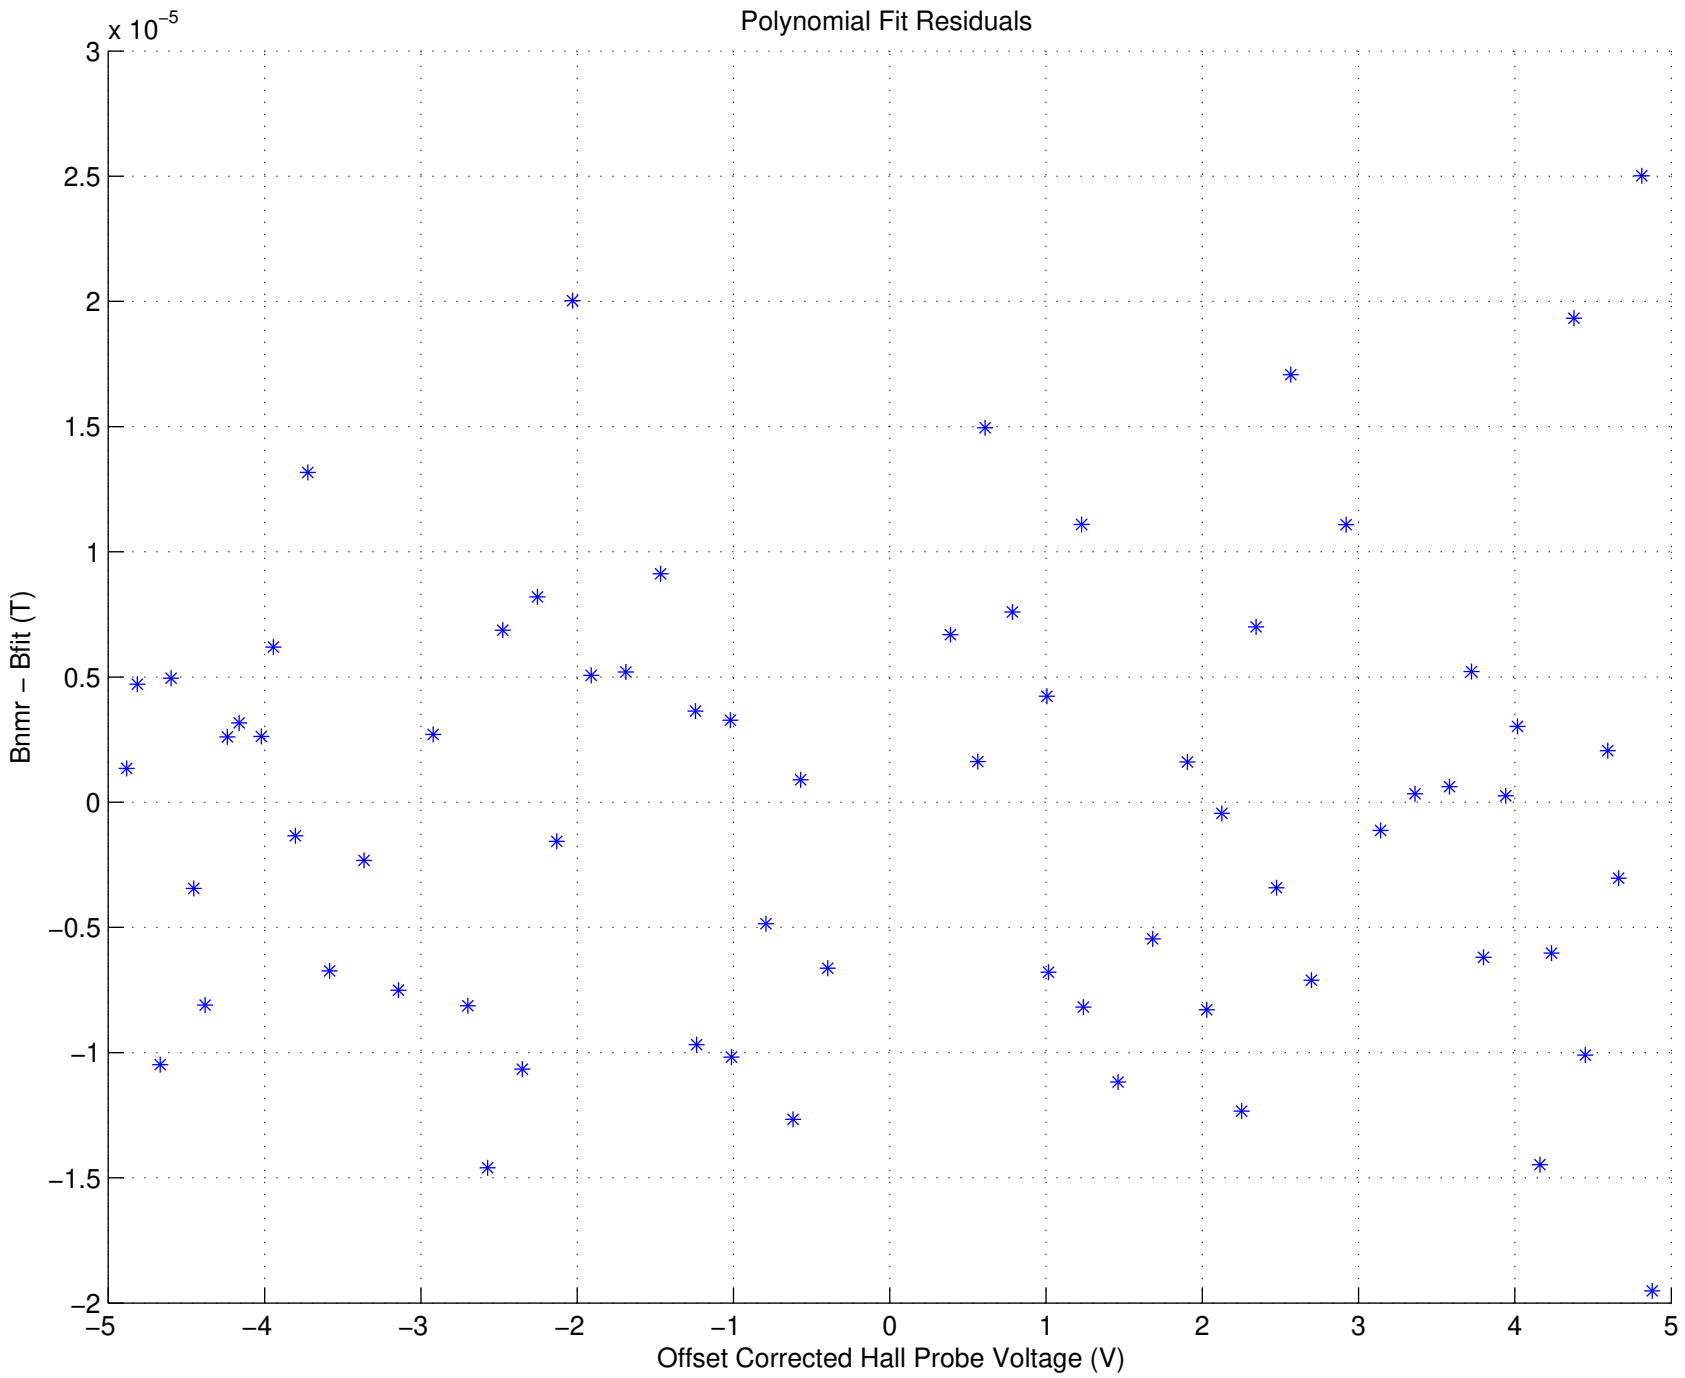
Polynomial Fit Residuals
x 10^-5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
−0.5
−1
−1.5
−2
−5
−4
−3
−2
−1
0
1
2
3
4
5
Bnmr − Bfit (T)
Offset Corrected Hall Probe Voltage (V)

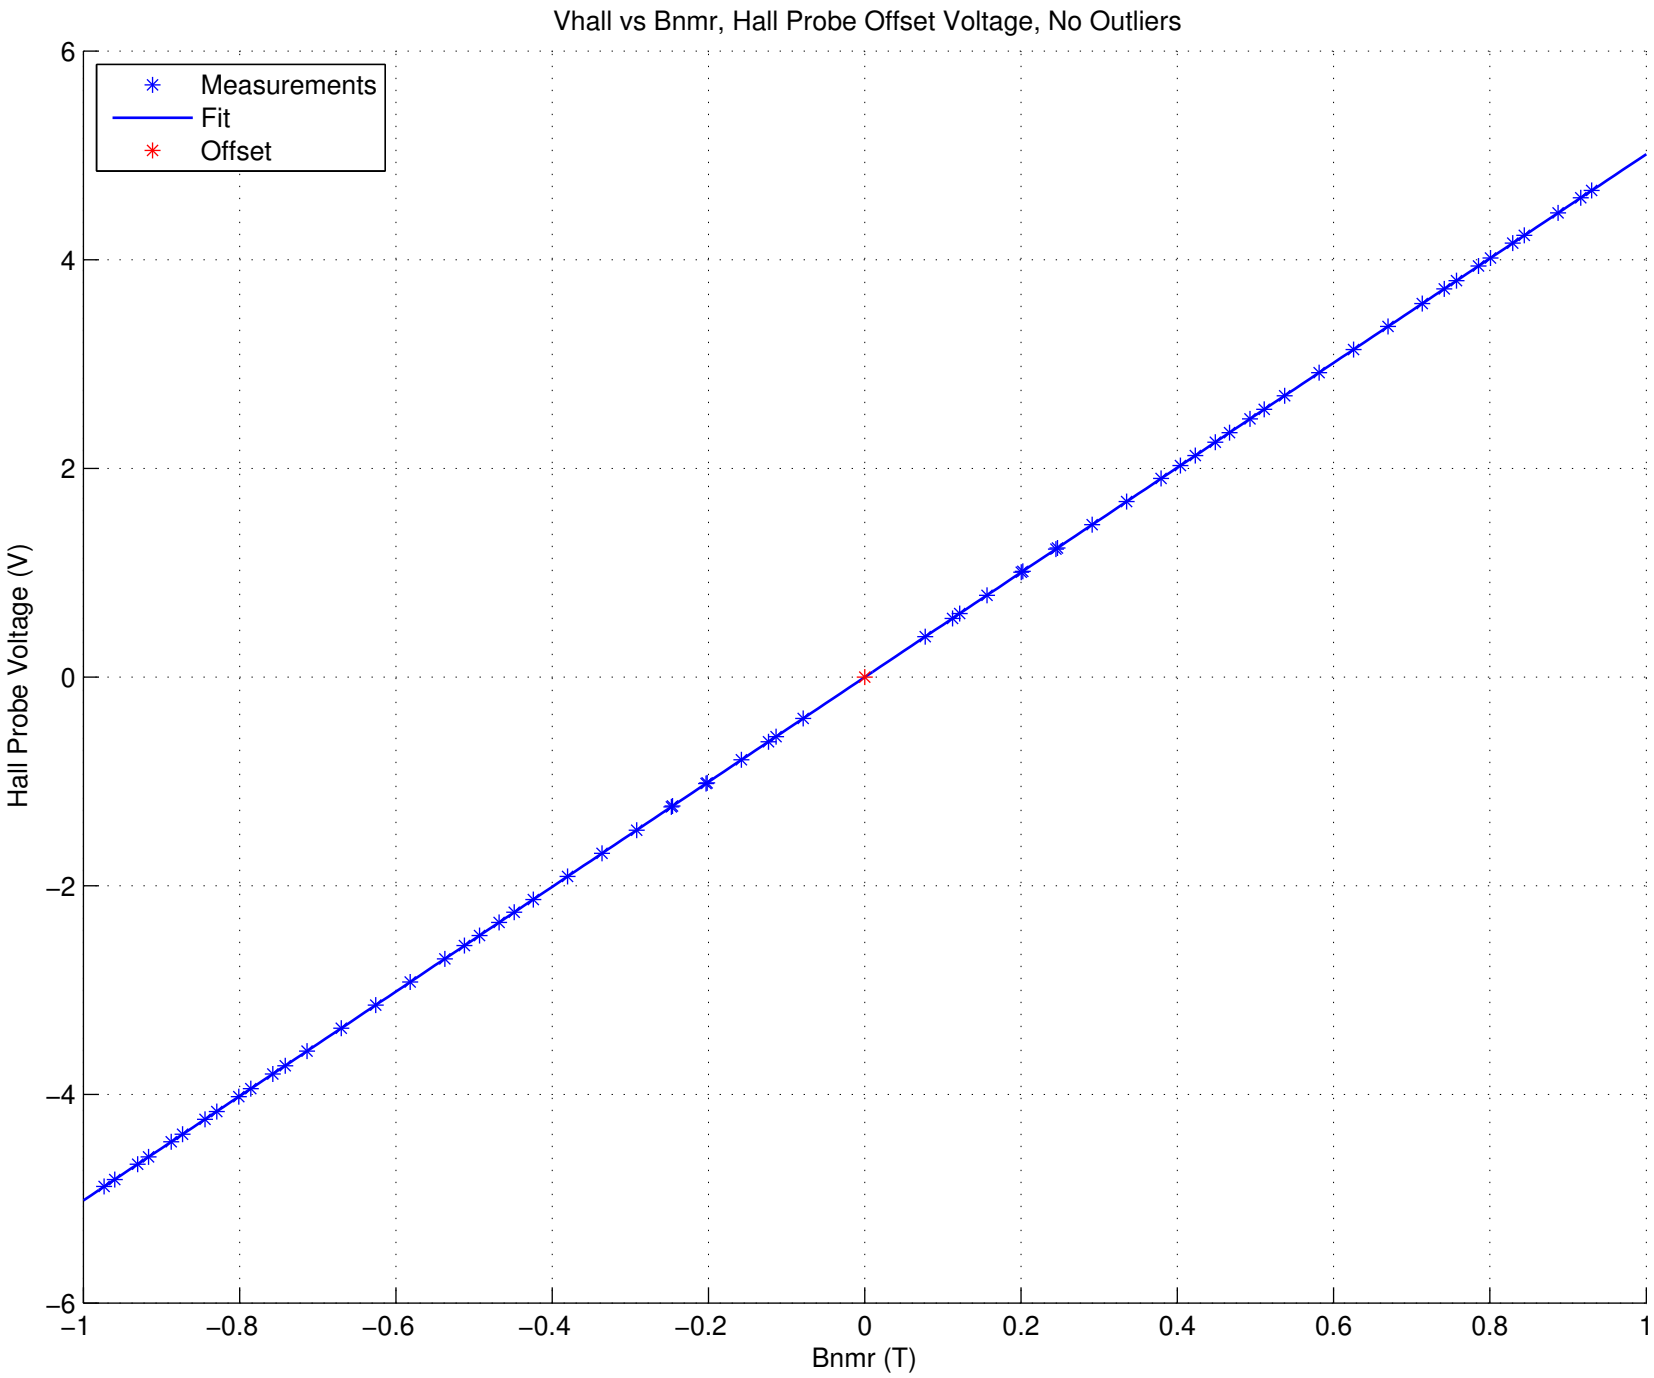
Vhall vs Bnmr, Hall Probe Offset Voltage, No Outliers
Measurements
Fit
Offset
Hall Probe Voltage (V)
Bnmr (T)
6
4
2
0
−2
−4
−6
−1
−0.8
−0.6
−0.4
−0.2
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1

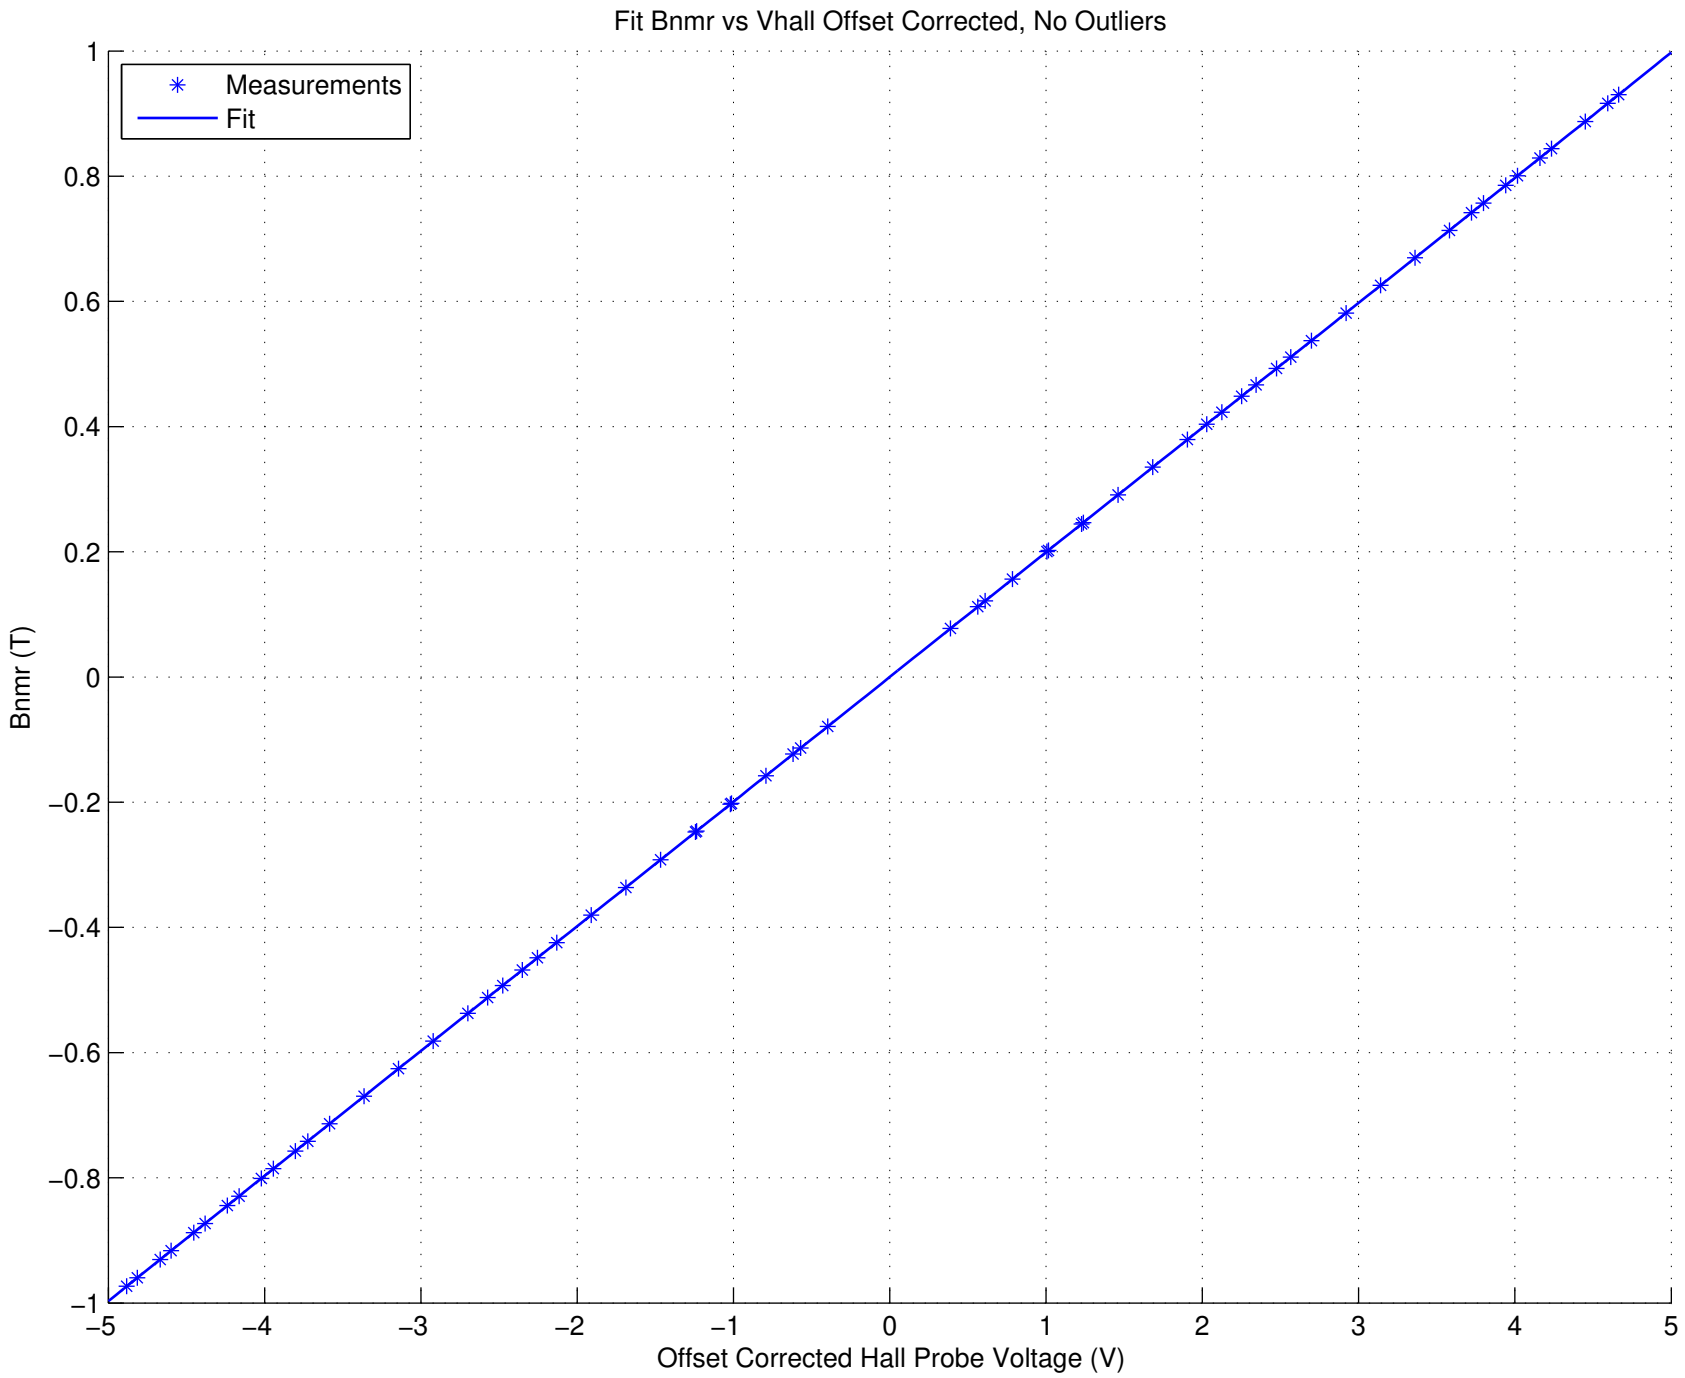
Fit Bnmr vs Vhall Offset Corrected, No Outliers
Measurements
Fit
Bnmr (T)
Offset Corrected Hall Probe Voltage (V)
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
−0.2
−0.4
−0.6
−0.8
−1
−5
−4
−3
−2
−1
0
1
2
3
4
5

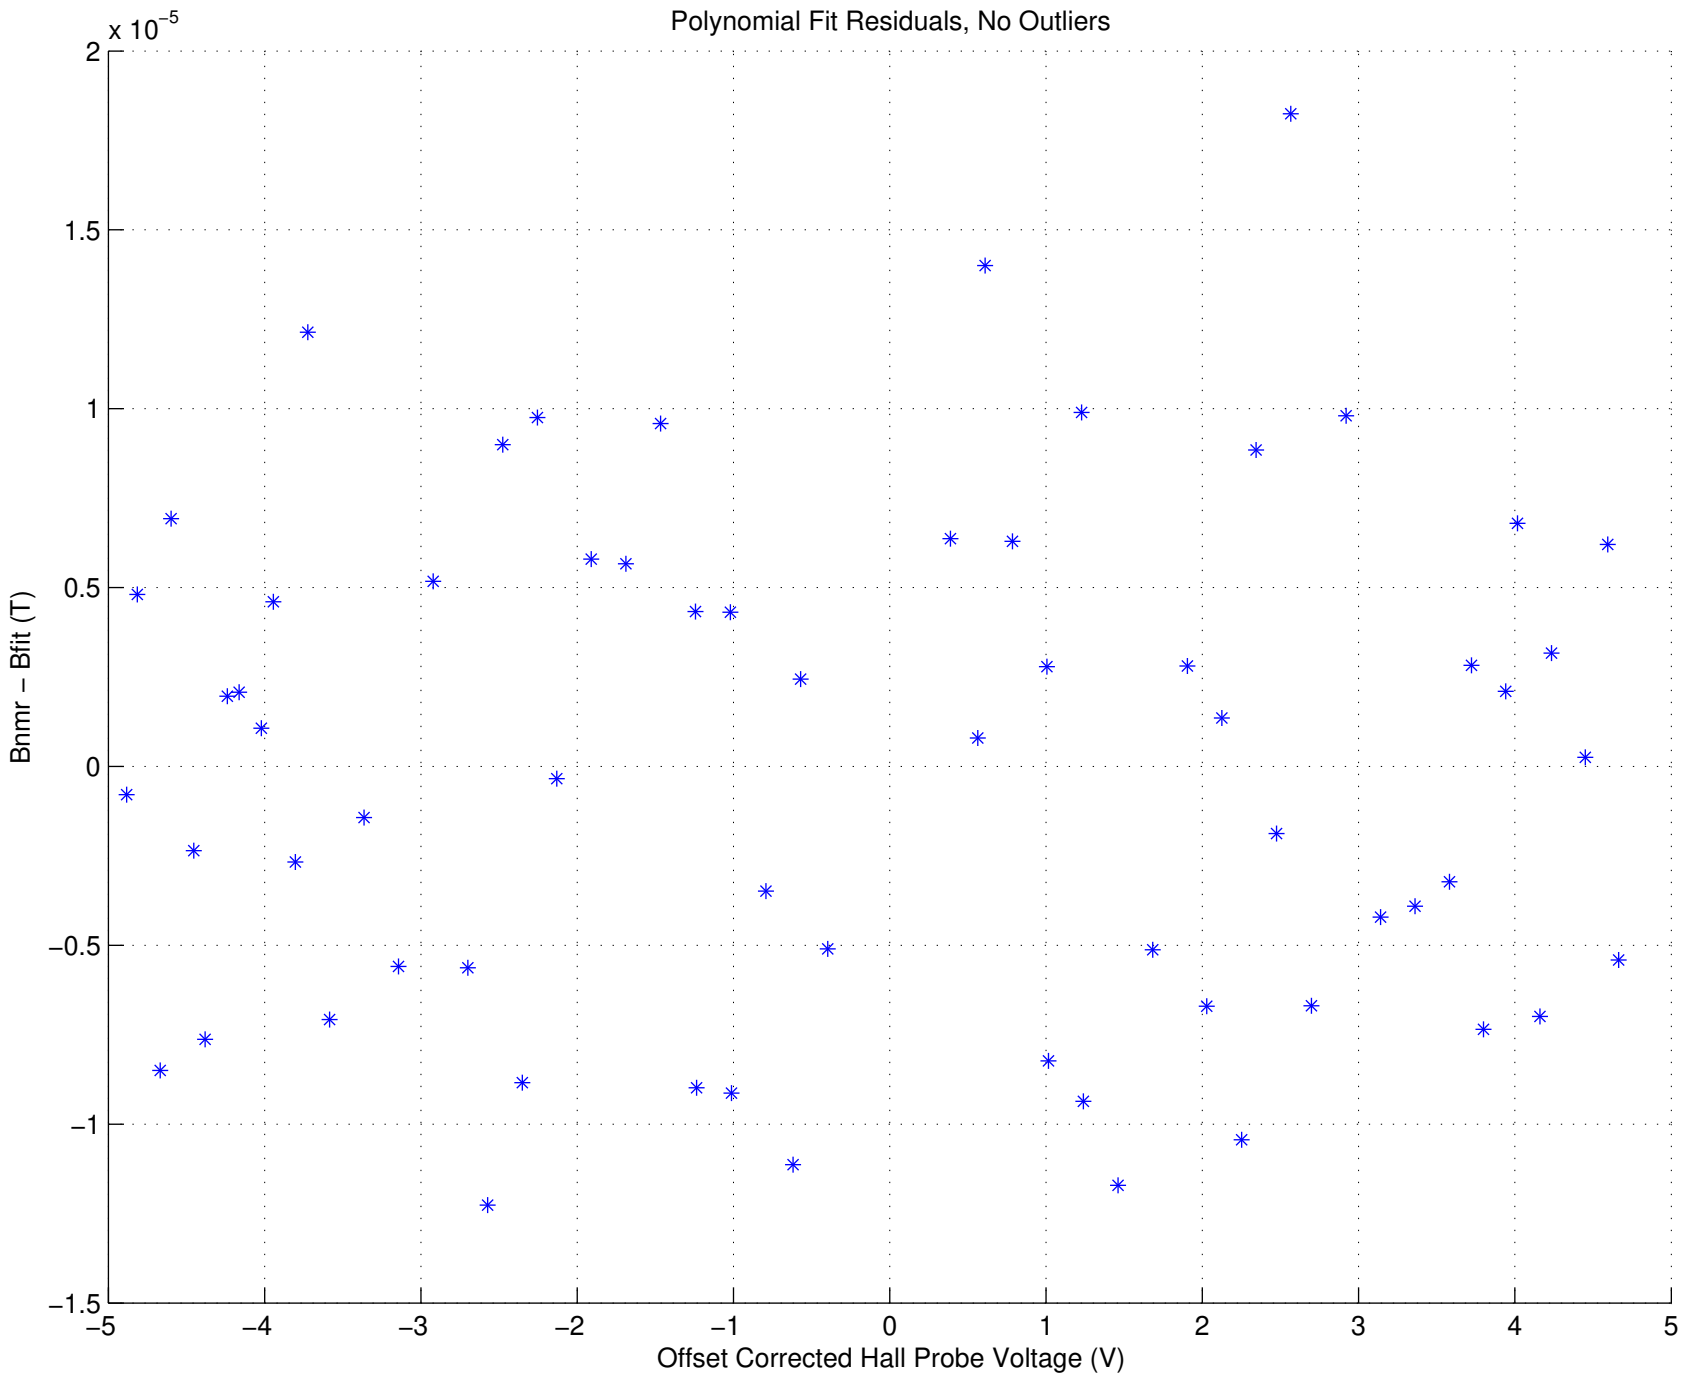
Polynomial Fit Residuals, No Outliers
x 10^-5
2
1.5
1
0.5
0
−0.5
−1
−1.5
−5
−4
−3
−2
−1
0
1
2
3
4
5
Bnmr − Bfit (T)
Offset Corrected Hall Probe Voltage (V)

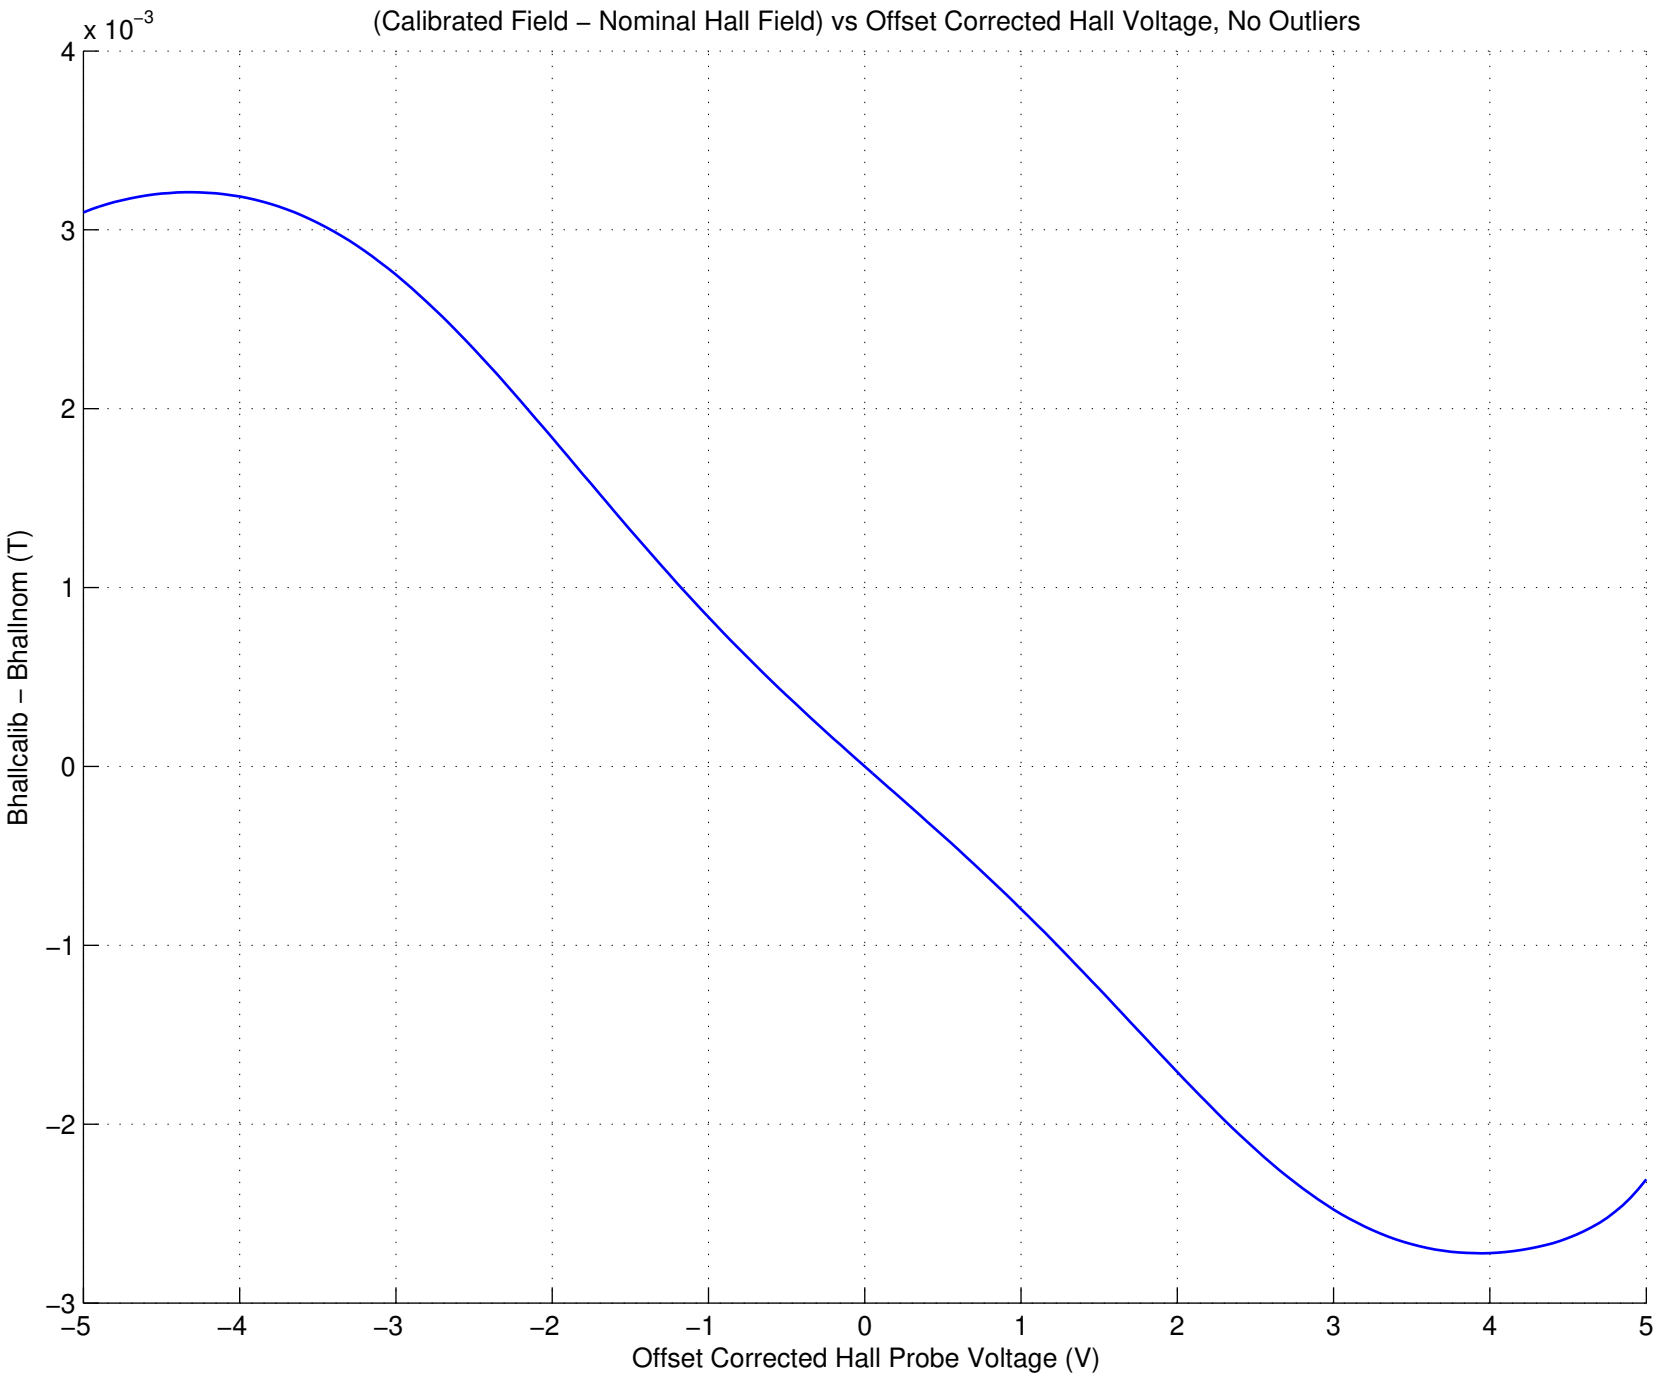
(Calibrated Field – Nominal Hall Field) vs Offset Corrected Hall Voltage, No Outliers
x 10^-3
4
3
2
1
0
−1
−2
−3
Bhallcalib – Bhallnom (T)
−5
−4
−3
−2
−1
0
1
2
3
4
5
Offset Corrected Hall Probe Voltage (V)