SLAC Magnetic Measurements#
Date: 03-02-2021#
Time: 14:32:56#

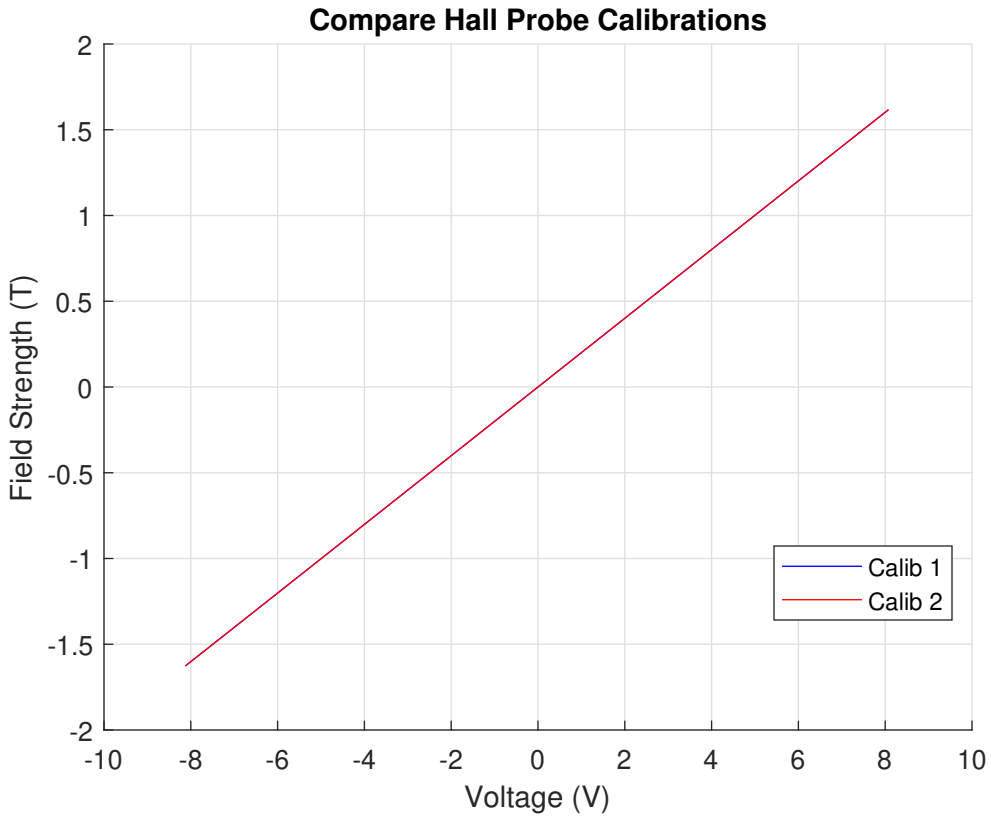
Compare Hall Probe Calibrations
Field Strength (T)
Voltage (V)
2
1.5
1
0.5
0
-0.5
-1
-1.5
-2
-10
-8
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
10
Calib 1
Calib 2

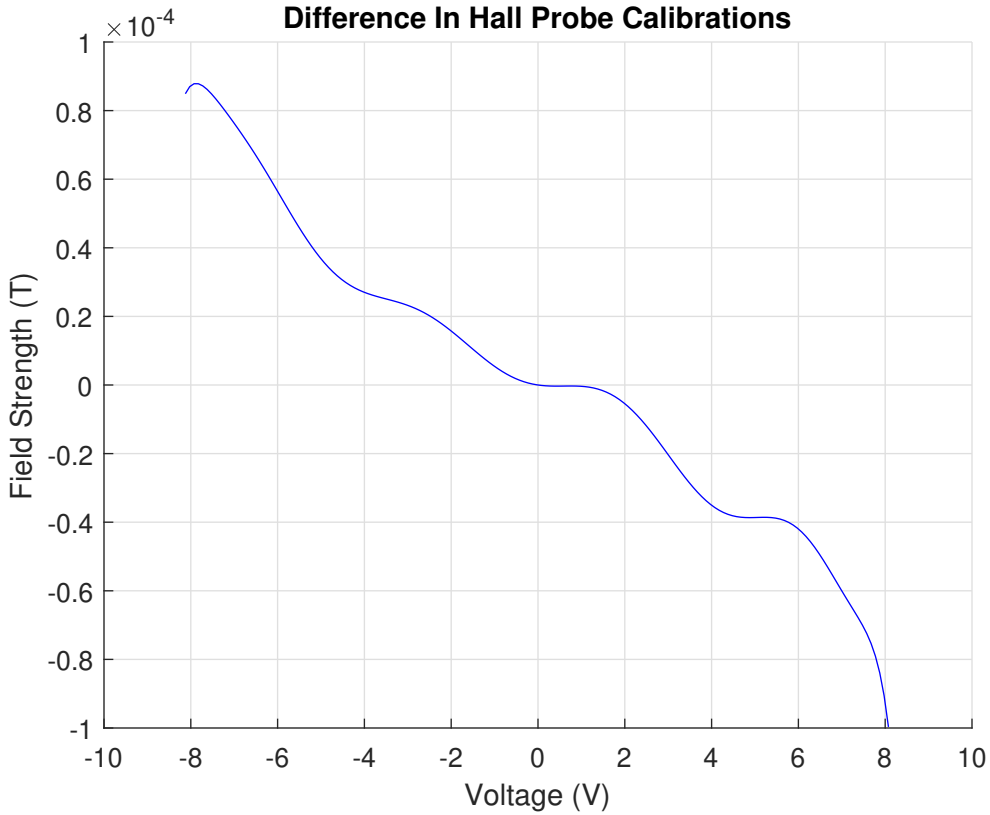
Difference In Hall Probe Calibrations
×10^-4
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
-0.2
-0.4
-0.6
-0.8
-1
Field Strength (T)
-10
-8
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
10
Voltage (V)