SLAC Magnetic Measurements#
Date: 10-19-2022#
Time: 08:40:37#

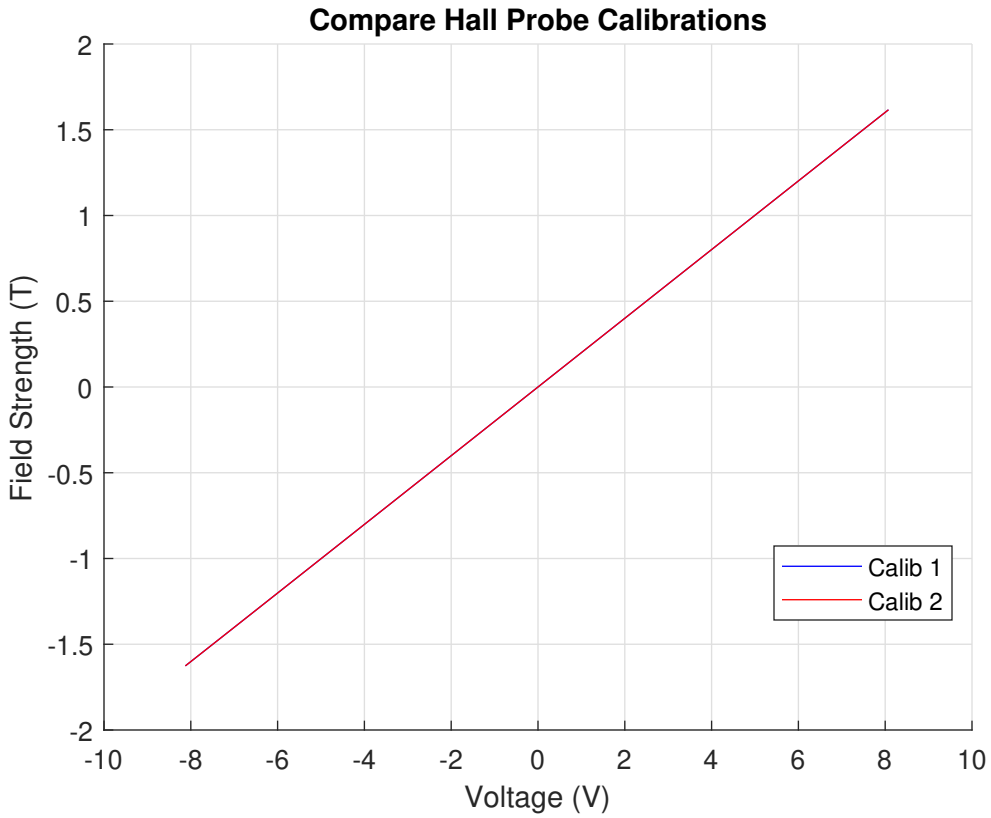
Compare Hall Probe Calibrations
Field Strength (T)
Voltage (V)
2
1.5
1
0.5
0
-0.5
-1
-1.5
-2
-10
-8
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
10
Calib 1
Calib 2

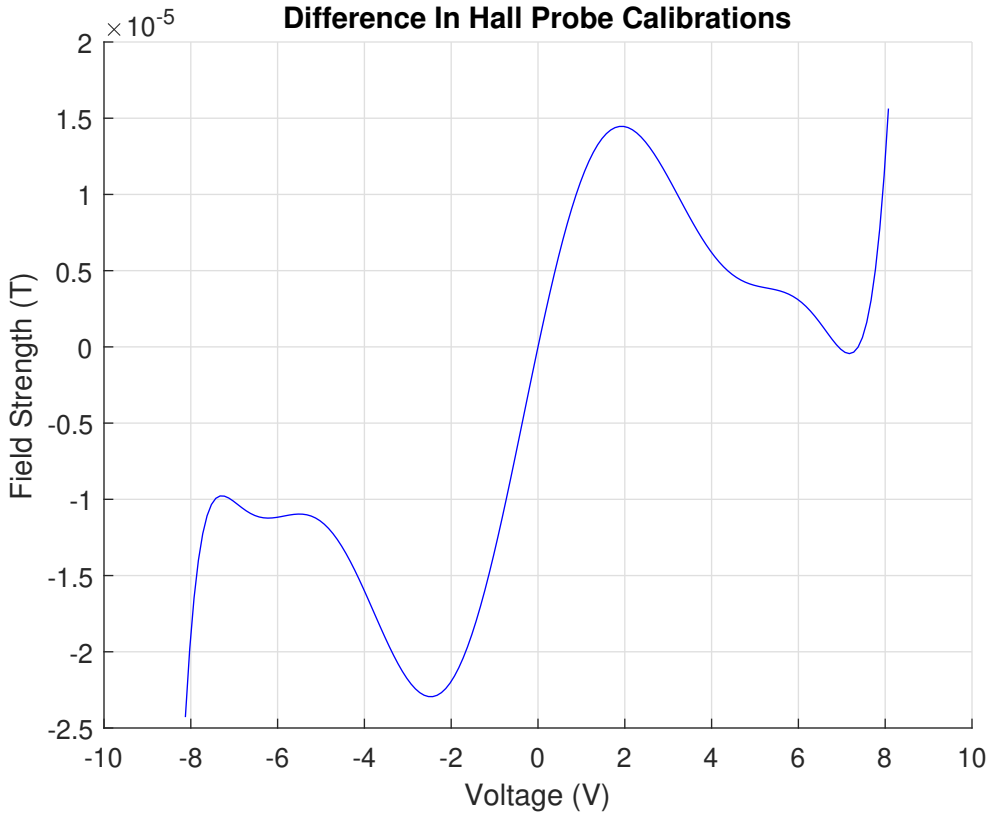
Difference In Hall Probe Calibrations
×10^-5
2
1.5
1
0.5
0
-0.5
-1
-1.5
-2
-2.5
Field Strength (T)
-10
-8
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
10
Voltage (V)