SLAC Magnetic Measurements

Planar Insertion Device Shim Analysis

Parameters:
INPUT−FILE−DIR =s:\magdata\LCLS\Undulator\L143−112000−16\DATASET0005\Fine Tuning\Z Scans\Run 007\
INPUT−FILE−NAME =x+00000−y+000−bscanz.dat
INPUT−FILE−TYPE =ZVXYBXYH
CORR−REQUIRED =1
GAMMA =26660.92
NOM−LAMBDA−U =0.03
NOM−K−VALUE =3.4931
NOM−LAMBDA−R =1.4985e−010
NUM−POLES =226
NUM−END−POLES =4
CELL−LENGTH =3.656

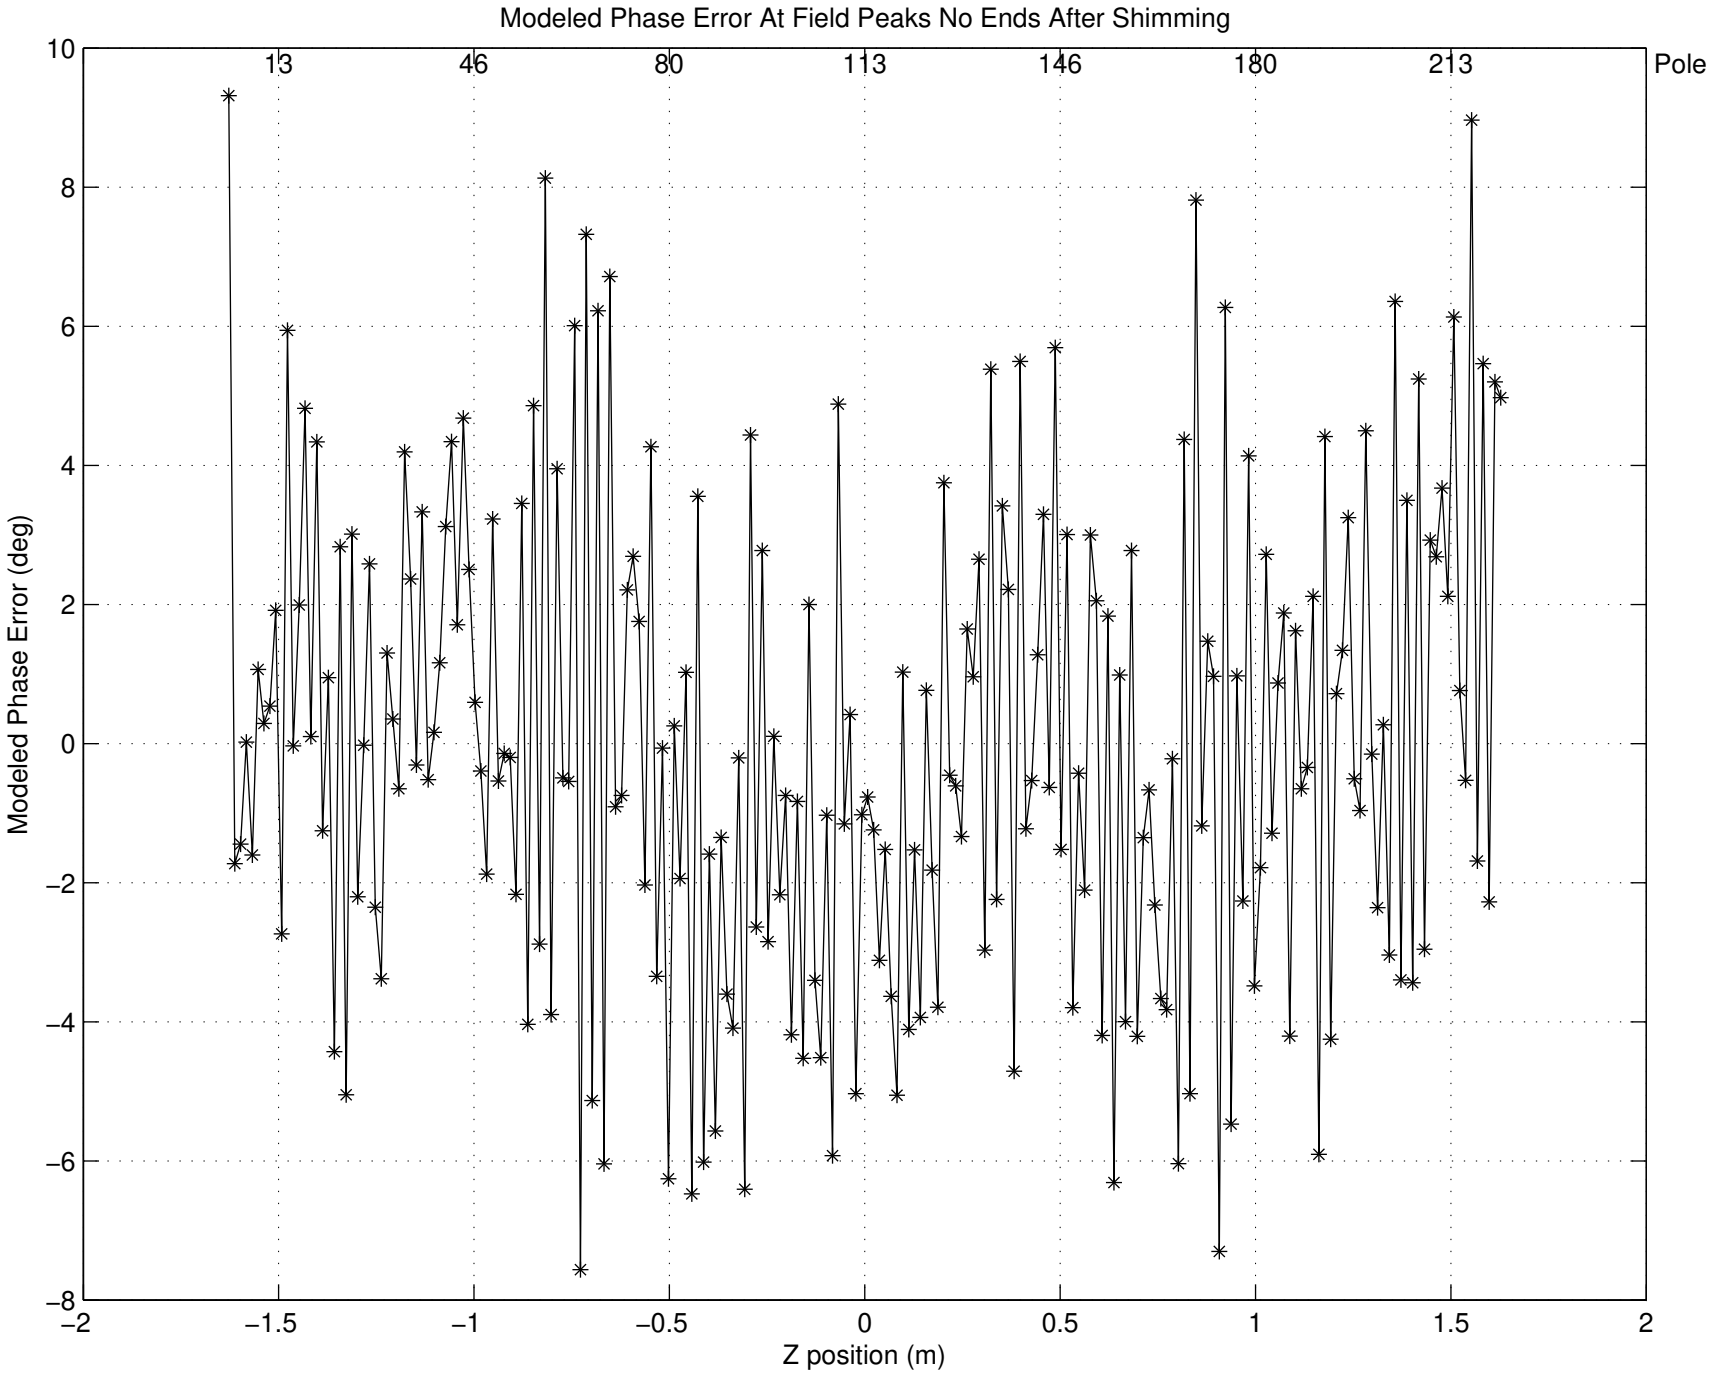

Phase Error: Ave = 0.000000 deg, RMS = 3.494015 deg